

Bearbeitung des DAHZ/BZÄK-Hygieneplans im Adobe Reader XI

Mit der neuen Version stehen zusätzliche Möglichkeiten für die Bearbeitung von Formularen zur Verfügung.

Streichung nicht eingesetzter Verfahren:

Kommentar – Grafikmarkierungen – Linie

Linie über den zu streichenden Bereich ziehen

The screenshot shows the Adobe Reader XI interface. The main content is a table titled "semikritisch A (maschinelle Verfahren)". The table has four columns: "WIE", "WOMIT", "ANWEISUNGEN", and "WER". A red diagonal line is drawn across the table from the bottom-left to the top-right. A blue arrow points from the "Grafikmarkierungen" (Graphic Markings) section of the right-hand toolbar to the red line. The toolbar includes options for "Anmerkungen" (Comments), "Grafikmarkierungen" (Graphic Markings), and "Kommentarliste" (Comment List).

	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER
ittelle,	Verfahren 1.1: Validiertes Verfahren im RDG	Gerät / Programm:	<ul style="list-style-type: none">nach jeder Verwendung am Patienten	alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten befasst sind
men	oder Verfahren 1.2: Verfahren im RDG bei dem nur die Reinigung validiert wurde	Gerät / Programm:	<ul style="list-style-type: none">bei Bedarf nicht fixierende Vorreinigung (z.B. Zementreste mit Zeilstofftücher entfernen)	
	anschließend Verfahren 4: thermische Behandlung (Desinfektion) unverpackt im Dampfsterilisator)*	Gerät / Programm:	<ul style="list-style-type: none">ggf. weitergehende Vorbereitung (z.B. Zerlegen)	
	oder			

Mit Mausklick rechts können die Eigenschaften der Linie geändert werden:

The screenshot shows the "Linien-Werkzeug - Eigenschaften" (Line Tool - Properties) dialog box. It has a tab labeled "Erscheinungsbild" (Appearance) and a sub-tab labeled "Allgemein" (General). The dialog contains several settings for the line:

- Anfang: Kein (dropdown)
- Ende: Kein (dropdown)
- Stil: (dropdown)
- Stärke: 1 pt (spinners)
- Farbe: (color swatch)
- Füllfarbe: (color swatch)
- Deckkraft: 100% (slider)

At the bottom, there is a checkbox for "Gesperrt" (Locked) and two buttons: "OK" and "Abbrechen" (Cancel).

Zufügen von eigenem Text

Ausfüllen und Unterschreiben – Text hinzufügen

Mausklick auf dem Bereich, der beschriftet werden sollte

Text eingeben

ggf. Texteigenschaften anpassen

The screenshot shows a software interface with a top toolbar containing icons for undo, redo, comment, and text insertion. The main menu has three tabs: 'Werkzeuge', 'Ausfüllen und Unterschreiben' (highlighted in yellow), and 'Kommentar'. Below the menu is a green bar with a button 'Vorhandene Felder markieren'. A 'Text hinzufügen' dialog box is open, showing a text input field with 'Text hinzufügen', a font dropdown set to 'Helvetica', and a size dropdown set to '9'. A red arrow points from the 'Text hinzufügen' button in the right-hand sidebar to the dialog box. The sidebar also contains options like 'Häkchen hinzufügen', 'Initiale platzieren', and 'Unterschrift platzieren'. Below the dialog is a table with three columns: 'WOMIT', 'ANWEISUNGEN', and 'WER'. The 'ANWEISUNGEN' cell contains a yellow highlight with the text 'Dies ist eingefügter Text'. The table content is as follows:

	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER
	Flüssigwaschpräparat aus Direktspender Trocknen mit Handtuch zum Einmalgebrauch (Box, Spender)	<ul style="list-style-type: none">• vor Arbeitsbeginn• bei sichtbarer Verschmutzung• nach Arbeitsende Dies ist eingefügter Text	alle Beschäftigten
hende während	Händedesinfektionsmittel aus Direktspender (4)		

Abdecken nicht benötigter Bereiche:

Kommentar – Grafikmarkierungen – Rechteckwerkzeug

Über Rechtsklick Eigenschaften aufrufen:

„Farbe“ und „Füllfarbe“ auf Weiß / 100% Deckkraft setzen

Rechteck über abzudeckende Bereiche ziehen.

The screenshot shows a software interface with a table and a right-hand toolbar. The table is titled "semikritisch A (maschinelle Verfahren)" and has four columns: WIE, WOMIT, ANWEISUNGEN, and WER. The table content is as follows:

	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER
el	Verfahren 1.1: Validiertes Verfahren im RDG	Gerät / Programm:	<ul style="list-style-type: none">nach jeder Verwendung am Patienten	alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind
en		Gerät / Programm:	<ul style="list-style-type: none">bei Bedarf nicht fixierende Vorreinigung (z.B. Zementreste mit Zellstoffpapier entfernen)	
		Gerät / Programm:	<ul style="list-style-type: none">ggf. weitergehende Vorbereitung (z.B. Zerlegen)	
	oder Verfahren 3:	Gerät / Programm:		

The right-hand toolbar contains various icons for drawing and editing. A yellow rectangle icon is highlighted, and a blue arrow points from it to a cell in the table. The toolbar also includes sections for "Anmerkungen", "Grafikmarkierungen", and "Kommentarliste (7)".


The screenshot shows the "Rechteck - Eigenschaften" dialog box. It has two tabs: "Allgemein" and "Überprüfungsverlauf". The "Allgemein" tab is active. The dialog contains the following settings:

- Stil: [Dropdown menu]
- Stärke: 1 pt
- Farbe:
- Füllfarbe:
- Deckkraft: 100%

At the bottom, there are checkboxes for "Gespert" and "Eigenschaften als Standard festlegen", and buttons for "OK" and "Abbrechen".

Beispiele für die Bearbeitung des DAHZ/BZÄK-Hygieneplans mit dem Adobe Reader DC

Kommentarwerkzeug aus der Seitenleiste auswählen

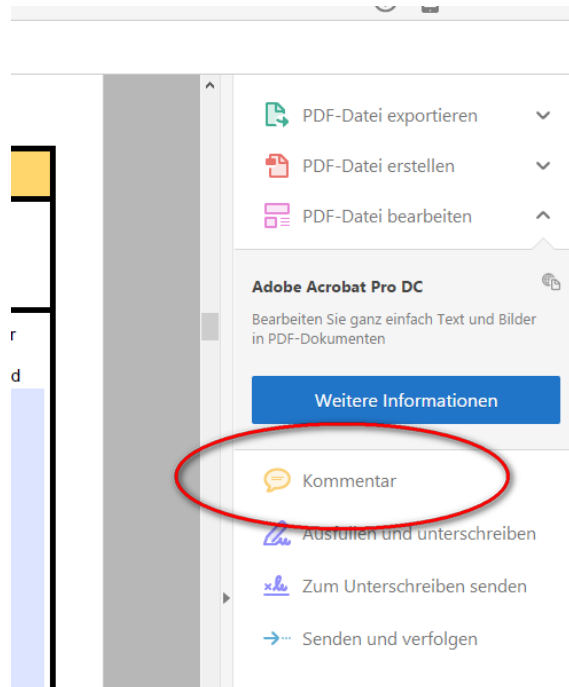

z.B. Streichung nicht eingesetzter Verfahren mit dem Werkzeug „Linie zeichnen“

The image shows the Adobe Acrobat Pro DC interface with a table titled 'Medizinprodukte semikritisch A (maschinelle Verfahren)'. The table has five columns: 'WAS', 'WIE', 'WOMIT', 'ANWEISUNGEN', and 'W'. A red line is drawn diagonally across the 'WIE' and 'WOMIT' columns. In the toolbar, the 'Linie zeichnen' (Draw Line) tool is circled in red. The table content is as follows:

WAS	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	W
Instrumente und Hilfsmittel für allgemeine, präventive, restaurative oder kieferorthopädische (nichtinvasive) Maßnahmen	Verfahren 1.1: Validiertes Verfahren im RDG	Gerät / Programm:	<ul style="list-style-type: none"> nach jeder Verwendung am Patienten bei Bedarf nicht fixierende Vorreinigung (z.B. Zementreste mit Zellstofftupfer entfernen) ggf. weitergehende Vorbereitung (z.B. Zerlegen) 	alle Beschäftigt Aufbereitung v Medizinprodukt
	oder Verfahren 1.2: Verfahren im RDG bei dem nur die Reinigung validebar ist	Gerät / Programm:		
	anschließend Verfahren 4: thermische Behandlung (Desinfektion) unverpackt im Dampfsterilisator)*	Gerät / Programm:		

z.B. Einfügen von zusätzlichem Text mit dem Werkzeug „Textkommentar hinzufügen“:

WAS	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN
Instrumente und Hilfsmittel für allgemeine, präventive, restaurative oder kieferorthopädische (nichtinvasive) Maßnahmen	Verfahren 1.1: Validiertes Verfahren im RDG	Gerät / Programm:	<ul style="list-style-type: none"> nach jeder Verwendung am Patienten
	oder Verfahren 1.2:	Gerät / Programm:	<ul style="list-style-type: none"> bei Bedarf nicht fixierende Vorreinigung (z.B. Zementreste mit Zellstofftupfer entfernen)
	anschließend Verfahren 4: thermische Behandlung (Desinfektion) unverpackt im Dampfsterilisator)*	Gerät / Programm:	<ul style="list-style-type: none"> ggf. weitergehende Vorbereitung (z.B. Zerlegen)

z.B. Anhängen von Dokumenten (z.B. Arbeitsanweisungen) mit dem Werkzeug „Datei anhängen“

Medizinprodukte semikritisch A (manuelle Verfahren)			
WAS	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN
Instrumente und Hilfsmittel für allgemeine, präventive, restaurative oder kieferorthopädische (nichtinvasive) Maßnahmen	Verfahren 2.1: Eintauchverfahren (bei Bedarf in Kombination mit Ultraschall)	Kombinationspräparat zur Reinigung und Desinfektion (2):	<ul style="list-style-type: none"> nach jeder Verwendung am Patienten
		Dosierung / Einwirkzeit:	<ul style="list-style-type: none"> ggf. weitergehende Vorbereitung (z.B. Zerlegen)